

窒素酸化物・浮遊粒子状物質 自動計測器

本装置は化学発光方式による窒素酸化物自動計測器 (NA-721)とβ線吸収方式による浮遊粒子状物質自動計測器 (PM-711)をラックに統合した複合計測器です。

交流法の採用でゼロドリフトの小さい
高精度測定を実現


ふっ素樹脂テープろ紙を標準採用し湿度や
ガス成分の影響の少ない高精度測定を実現

大型カラーLCDタッチパネルを採用し
豊富な情報表示と快適な操作性を実現

大容量のデータメモリを内蔵し
測定データ、動作情報を1年分保存可能


汎用USBメモリで
測定データの取出しが可能

環境省テレメータ取り合い共通仕様に適合した
デジタルテレメータ入出力機能を標準装備

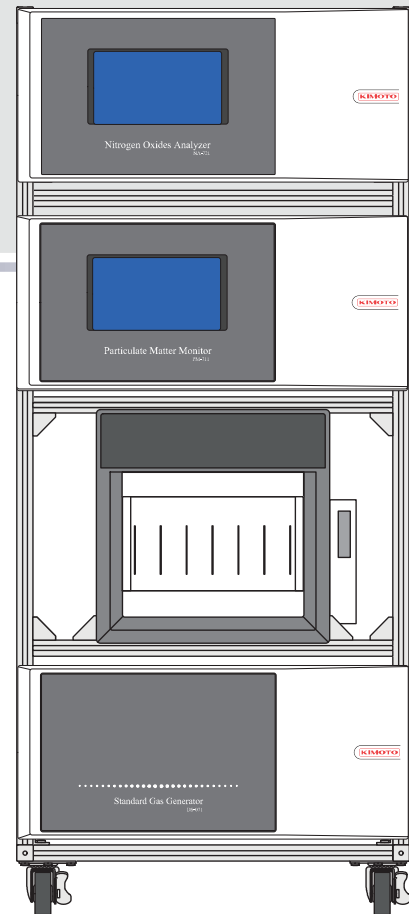

NAP-700

■ 分析部本体およびラックケース寸法

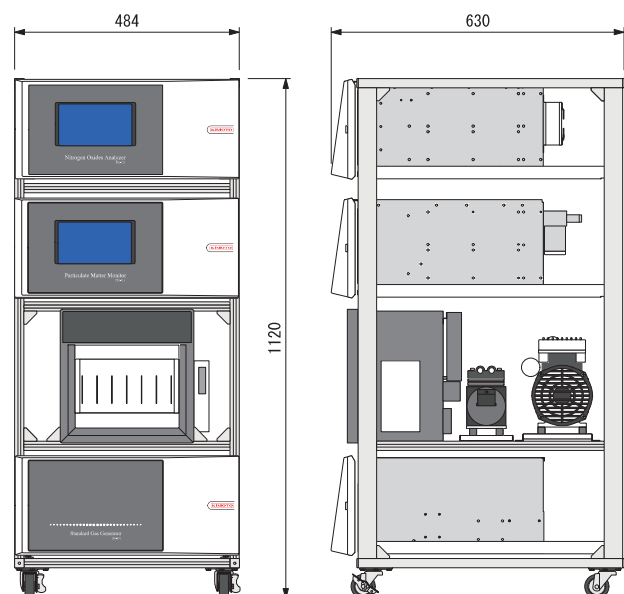

ラック組込型 (A1120) (DS-071N付:約76kg)

■ 基本構成

窒素酸化物自動計測器	NA-721
浮遊粒子状物質自動計測器	PM-711
床立型ラック	A1120:高さ1120mm キャスタ付フレームラック
レコーダ	打点式記録計 記録紙有効幅180mm 記録速度25mm/h
アナログテレメータ 入出力ユニット	TU07:ネジ締め端子台 (床立型ラック背面取付)

■ 周辺装置

標準ガス調製装置	DS-071N:流量比混合1点希釈装置 NA-721からの自動制御運転 コンバータ効率試験ガス発生機能(オプション) 高純度ゼロガス発生器内蔵
----------	--

■ NA-721 仕様

測定対象	環境大気中の窒素酸化物 (NO ₂ , NO, NO _x)	暖機時間	3時間以下
測定原理	化学発光方式 (JIS B 7953)	許容周囲温度	0~40℃
測定範囲*	0~1ppm (標準), 0~2ppm (オプション)	試料吸引流量	約1L/分
アナログ出力レンジ*	0~0.1/ 0.2/ 0.5/ 1ppm 4レンジ自動切換 (標準), 0~0.2/ 0.5/ 1/ 2ppm 4レンジ自動切換 (オプション) ※任意レンジからのスタート設定可能 ※固定レンジ設定可能	ダストフィルタ*	φ47mmふっ素樹脂フィルタ
繰返し性(再現性)	スパンガス濃度の±1%	LCD表示	測定値, 出力レンジ, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
ゼロドリフト	±1ppb/週	内部メモリー保存	測定値(1分値, 1時間値), 動作制御情報, メッセージ, アラーム
スバンドリフト	スパンガス濃度の±2%/日, ±4%/週	デジタル入出力	Ethernet, USB (使用できないUSBメモリもあります。詳しくはお問い合わせください)
直線性(指示誤差)	中間点スパンガス濃度の±4%	打点式記録計用出力*	連続値, 1時間積算平均値, 日報, 動作情報
電源電圧変動に対する指示値の安定性	スパンガス濃度の±1%/100±10V	デジタルテレメータ用入出力	環境省環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様に適合した入出力
周囲温度変化に対する指示値の安定性	ゼロ: ±1ppb以内/5℃変化 スパン: スパンガス濃度の±2%以内/5℃変化	アナログテレメータ用入出力*	DC0~1V: 連続値, 1時間積算平均値 接点信号: 出力レンジ, 外部リセット, 調整中, 電源断, 親局停止, 動作不良等
コンバータ効率	96%以上	電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 約300VA
応答時間	3分以下(最終指示値の90%までの時間)	耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間印加で異常なし
検出限界	1ppb以下	絶縁抵抗	5MΩ以上
干渉影響	4ppb以下 (NH ₃ 1ppm), 4%以下 (水分 25℃ 80%RH)		

(*) 標準外仕様についてはご相談ください。

■ PM-711 仕様

測定対象	環境大気中の浮遊粒子状物質	捕集ろ紙	ふっ素樹脂製テープろ紙
測定原理	β線吸収方式 (JIS B 7954)	β線源*	¹⁴ C 放射線障害防止法規定下限数量 (10MBq) 未満 (取扱資格及び届出不要)
測定範囲*	0~5mg/m ³	検出器	プラスチックシンチレーション検出器
アナログ出力レンジ*	0~0.5/ 1/ 2/ 5mg/m ³ 4レンジ自動切換 ※任意レンジからのスタート設定可能 ※固定レンジ設定可能	分級装置*	SPMサイクロン(標準), PM _{2.5} サイクロン(オプション), PM ₁₀ インパクタ(オプション)
繰返し性(再現性)	等価膜値の±2%	LCD表示	測定値, 出力レンジ, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
ゼロドリフト	±5.0μg/m ³ /日	内部メモリー保存	測定値, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
スバンドリフト	等価膜値の±3%/日	デジタル入出力	Ethernet, USB (使用できないUSBメモリもあります。詳しくはお問い合わせください)
直線性(指示誤差)	等価膜値の±5%	打点式記録計用出力*	1時間積算平均値, 日報, 動作情報
校正用空気に対する指示値	質量濃度の±10%	デジタルテレメータ用入出力	環境省環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様に適合した入出力
粒子状物質を含まない空気に対する指示値(空試験)	±5.0μg/m ³ (平均値)	アナログテレメータ用入出力*	DC0~1V: 1時間積算平均値 接点信号: 出力レンジ, 外部リセット, 調整中, 電源断, 親局停止, 動作不良等
電源電圧変動に対する指示値の安定性	等価膜値の±3%/100±10V	電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 約400VA
電源電圧変動に対する試料大気流量の安定性	設定試料大気採取流量の±5%/100±10V	耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間印加で異常なし
試料大気採取流量	16.7L/分 (20℃, 1atm)	絶縁抵抗	5MΩ以上
試料大気流量の経時安定性	設定試料大気採取流量の±5%/10日		

(*) 標準外仕様についてはご相談ください。



安全に関するご注意

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。

人・社会・自然の関わりをはかる

KIMOTO

紀本電子工業株式会社

<https://www.kimoto-electric.co.jp/>

■ 本社・工場

〒543-0024 大阪市天王寺区舟橋町3-1
TEL 06-6768-3401 FAX 06-6764-7040

■ 東京営業所

〒140-0013 東京都品川区南大井3-24-13
TEL 03-3761-8191 FAX 03-3761-8194

☑ E-Mail

sales@kimoto-electric.co.jp